


DECLARACIÓN DE EFICACIA DESINFECTANTE (TAMBIÉN VIRUCIDA CONTRA SARS-CoV-2)

Dispositivo de desinfección a vapor sin contacto / con contacto

La empresa **Polti Spa**, declara y certifica que los productos señalados como **“DDV” - Dispositivos de Desinfección a Vapor**, utilizados correctamente, **tienen eficacia bactericida, esporicida, fungicida, levuricida y virucida - también contra SARS-CoV-2.**

La eficacia ha sido probada por laboratorios terceros independientes en condiciones de suciedad con sustancias interferentes para la salud humana/médica de acuerdo con la norma afnor **NF T72-110 - marzo de 2019**

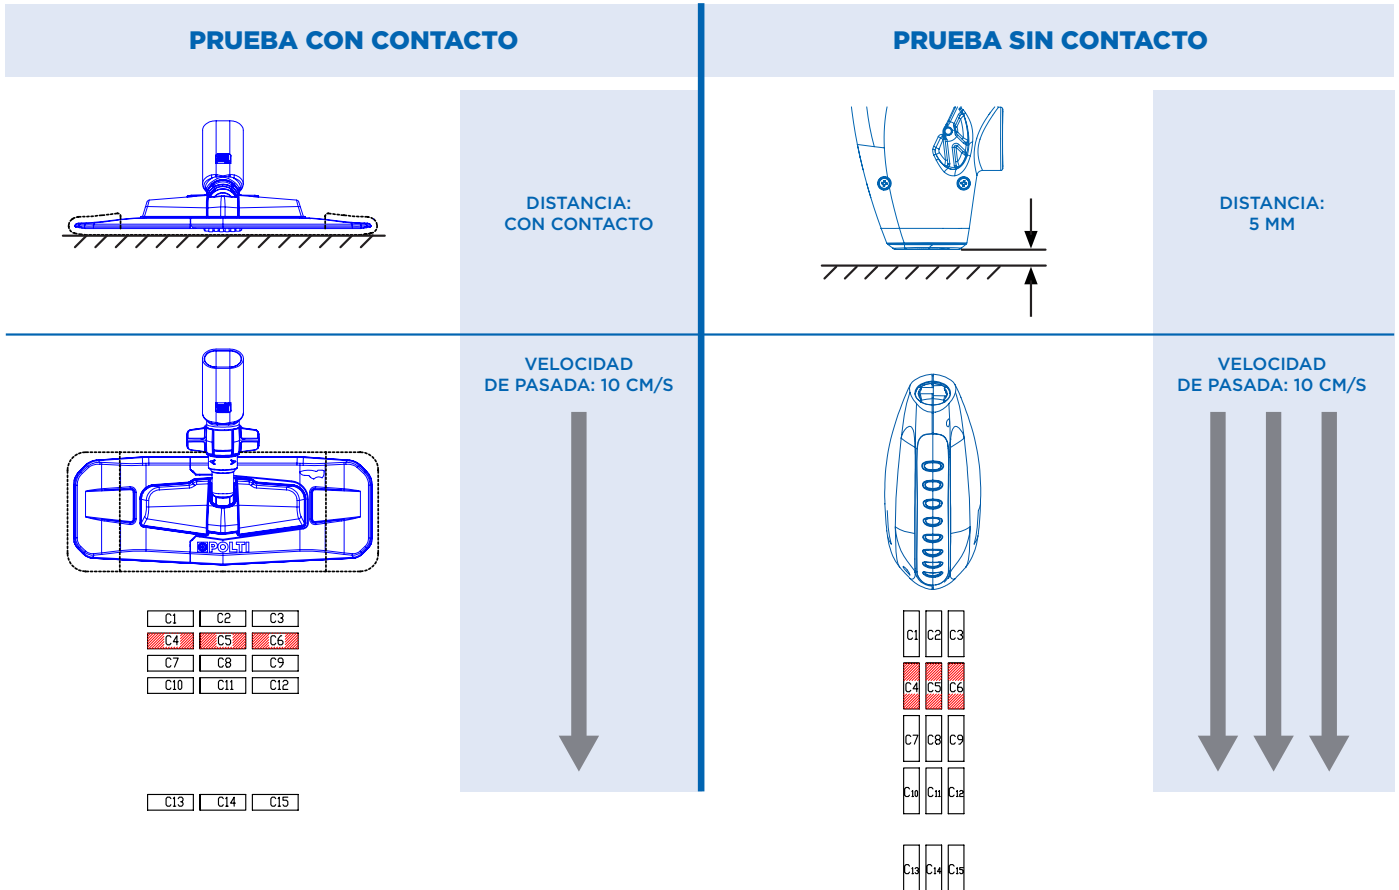

Banco de pruebas para la evaluación de dispositivos de vapor válido para pruebas de "contacto" y "sin contacto"
 C4 / C5 / C6 = áreas contaminadas con microorganismos
 La velocidad de paso cumple con la norma: 10 cm / s
 La distancia para la prueba "sin contacto" cumple con la norma: 5 mm
 En la prueba de "contacto", se realizó una sola pasada para todas las filas de muestras. En la prueba "sin contacto", se realizó una pasada para cada fila de muestras.

LOS PRODUCTOS QUE SE SOMETEN A ENSAYO, EN EL CORRECTO MODO DE FUNCIONAMIENTO, PREVISTO EN LA NORMA, OBTIENEN LAS SIGUIENTES REDUCCIONES:

- ≥5 Log - Bacterias - Actividad bactericida
- ≥4 Log - Virus - Actividad virucida
- ≥4 Log - Hongos - Actividad fungicida
- ≥4 Log - Levaduras - Actividad levuricida
- ≥3 Log - Esporas bacterianas - Actividad esporicida



**DISPOSITIVO
DE DESINFECCIÓN
A VAPOR**

(ref. AFNOR NF T72-110)



POLTI®